

Интерфейс IFC203/300/400/406 для регистратора данных КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Для Windows XP SP3 или более поздней версии

ВАЖНО: Не подключайте IFC к вашему ПК до получения соответствующих инструкций.



IFC203



IFC300



IFC400



IFC406

Комплекты кабелей интерфейса IFC обеспечивают связь между автономными регистраторами данных и программным обеспечением MadgeTech 4. Подключите IFC напрямую к ПК для начала и остановки работы регистратора данных или для загрузки показаний.

Установка программного обеспечения MadgeTech 4

Стандартное программное обеспечение MadgeTech 4 можно загрузить с сайта Datalogion.ru. Ознакомьтесь с руководством по программному обеспечению MadgeTech 4 для получения полных инструкций по установке.



1. Откройте папку MT4 из недавно загруженного файла и дважды щелкните файл MTInstaller.exe, чтобы запустить Мастер установки.
2. Выберите язык установки и нажмите **ОК**.
3. Примите Лицензионное соглашение с конечным пользователем и нажмите **Далее**.
4. Выберите параметры установки и нажмите **Далее**.
5. MadgeTech 4 готов к установке. Нажмите **Установить**, чтобы начать установку.
6. Нажмите **Готово**, когда установка будет завершена.

Для работы с программным обеспечением MadgeTech 4 требуется установленная на ПК платформа .NET Framework 4.0. Операционные системы Windows 8 и Windows 10 уже содержат более новую версию .NET Framework. Если платформа .NET Framework 4.0 не установлена на ПК, загрузите её с веб-сайта Microsoft.com.

После подтверждения установки платформы .NET Framework 4.0 установите программное обеспечение MadgeTech 4, следуя приведенным выше инструкциям.


Установка драйверов USB

Драйверы интерфейса USB можно легко установить на ПК, если они еще не доступны и не работают. Их можно скачать с веб-сайта datalogion.ru

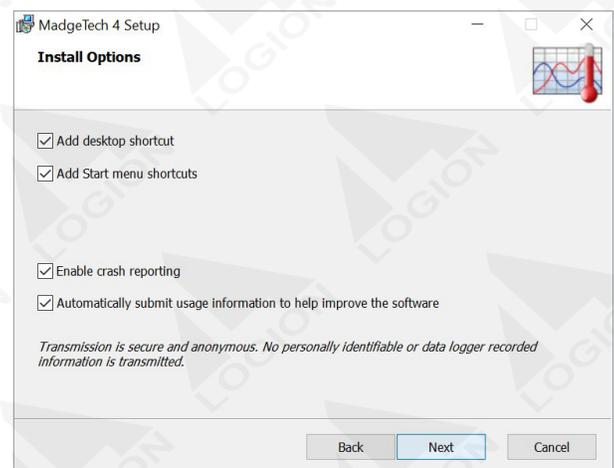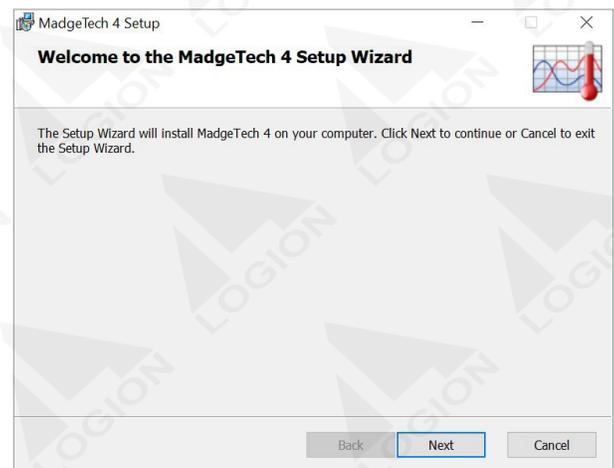


Подключение IFC к программному обеспечению MadgeTech 4

1. Снимите предупредительную наклейку с IFC, чтобы открыть USB-порт и подключить соответствующий конец USB-кабеля.
2. Подключите другой конец USB-кабеля к USB-порту на компьютере с операционной системой Windows. На экране появится сообщение, указывающее на установку нового USB-устройства и его готовность к использованию.
3. Проверьте правильность установки IFC, запустив программное обеспечение MadgeTech 4 и перейдя в меню Файл > Параметры > Связь. На экране должно отображаться установленное вами IFC.

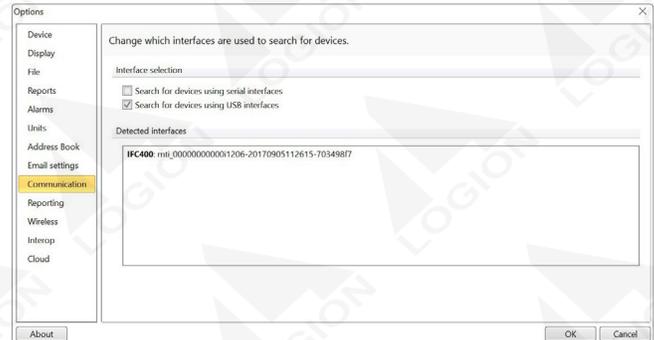

Тестирование соединения интерфейса и регистратора данных

1. Чтобы проверить правильность установки драйверов интерфейса, запустите программное обеспечение MadgeTech 4. (При необходимости обратитесь к руководству по программному обеспечению для получения дополнительных инструкций.)
2. Когда IFC подключен к ПК, индикатор синего светодиода должен гореть, если драйверы установлены правильно и интерфейс обнаружен Windows. Если индикатор не горит, отключите кабель интерфейса и убедитесь, что драйверы USB установлены. Подождите 5 секунд и снова подключите его к ПК.
3. Установите регистратор данных в док-станцию или подключите его к IFC.
4. Ваше устройство появится в панели подключенных устройств.

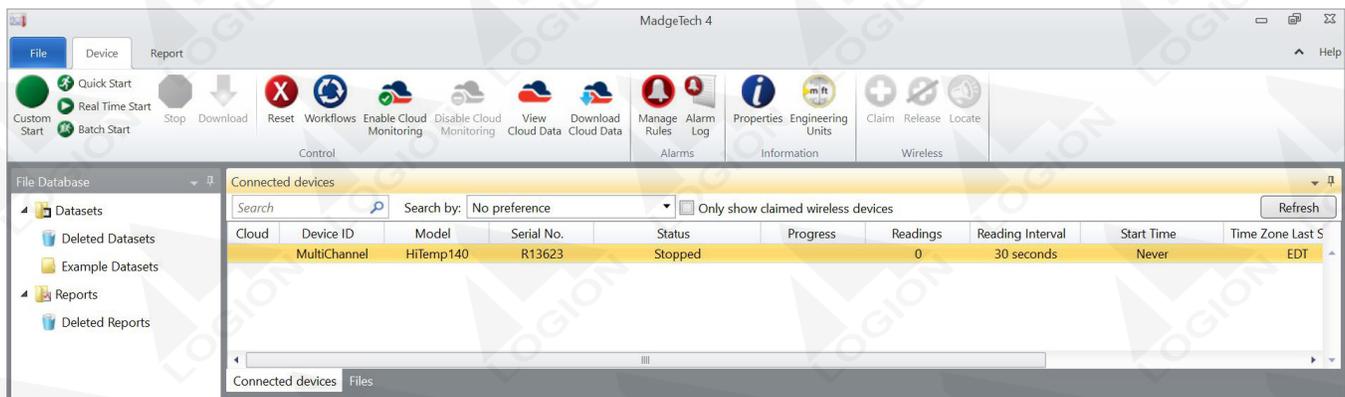

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации или помощи в устранении неполадок посетите наш сайт datalogion.ru, свяжитесь с нами по адресу info@datalogion.ru и ли звоните по телефону +7 (951) 862-38-07.